


# R-LAS Serie

## ▶ R-LAS-LT-300

- 300 mm Referenzabstand
- 10 mm Messbereich (bzw. 290 mm bei XL-Version)
- Fremdlichtunempfindlich
- Intensitätsunabhängige Auswertung
- Laserleistungsregelung
- Parametrisierbar unter Windows®
- RS232-Schnittstelle (USB-Adapter optional)
- Kratzfeste Optik
- Robustes Aluminiumgehäuse

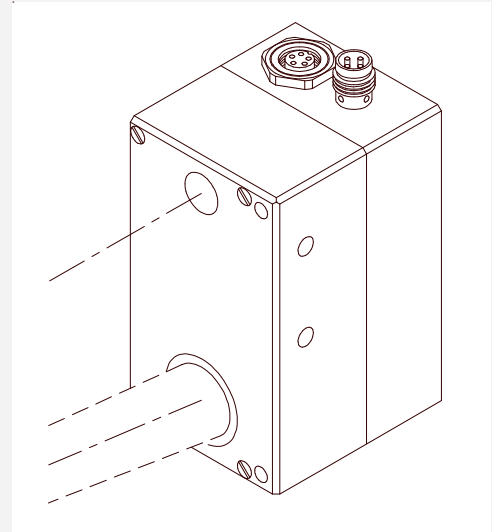


### Aufbau


#### Produktbezeichnung:

**R-LAS-LT-300**  
**R-LAS-LT-300-XL**  
**R-LAS-LT-300-ANA**  
**R-LAS-LT-300-ANA-XL**  
**R-LAS-LT-300-ANA-LIN**  
**R-LAS-LT-300-ANA-XL-LIN**  
 (incl. Software RT-Scope)




XL = großer Kontrollbereich  
 ANA = Analogausgang  
 LIN = linearisiert

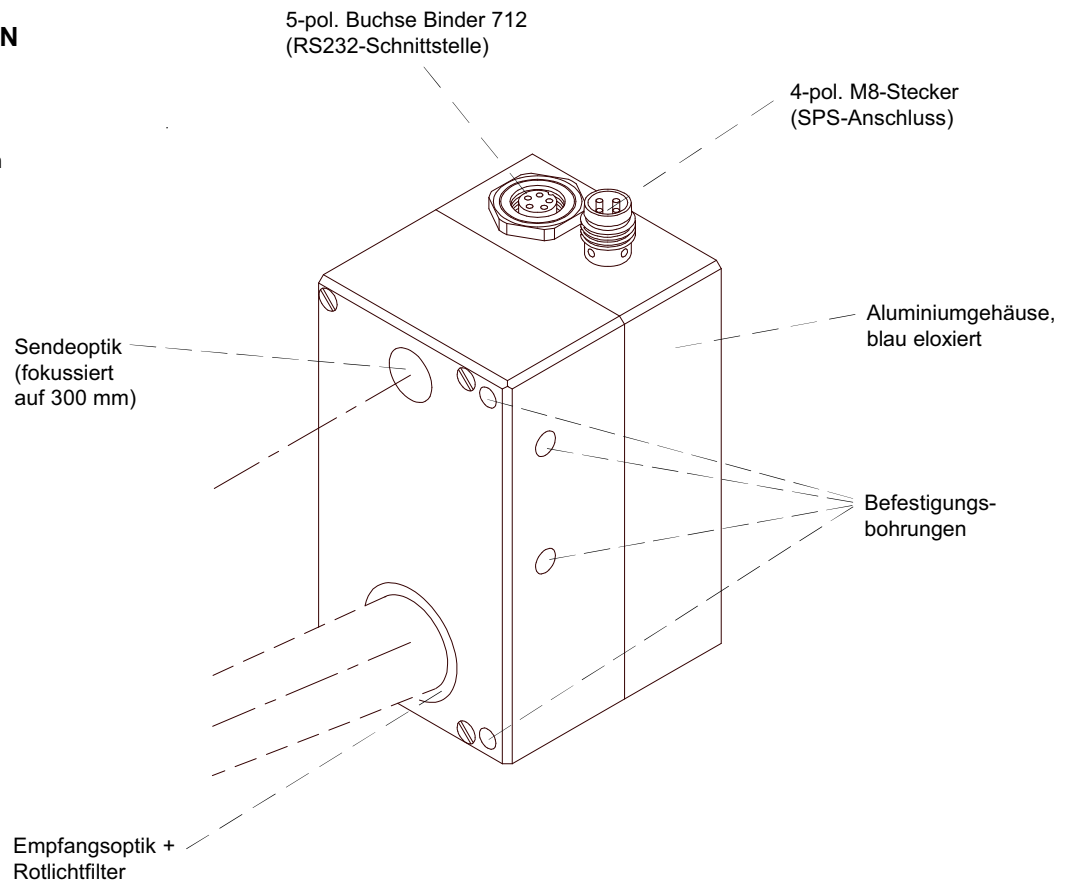

## Technische Daten

Typ	R-LAS-LT-300	R-LAS-LT-300-XL	R-LAS-LT-300-ANA (...-LIN)	R-LAS-LT-300-ANA-XL (...-LIN)
Laser	Halbleiterlaser, 670 nm, AC-Betrieb, 1mW max. opt. Leistung, Laserklasse gemäß DIN EN 60825. Für den Einsatz sind daher keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.			
Min. erkennbares Objekt	typ. 0.5 mm (in 300 mm Abstand)	typ. 0.5 mm (in 300 mm Abstand)	typ. 0.5 mm (in 300 mm Abstand)	typ. 0.5 mm (in 300 mm Abstand)
Referenzabstand	300 mm			
Arbeitsbereich	typ. ± 5 mm	typ. 210 mm ... 500 mm	typ. ± 5 mm	typ. 210 mm ... 500 mm
Reproduzierbarkeit	typ. 0.1 mm (abhängig von der Oberfläche des Messobjekts)	(abhängig von der Oberfläche des Messobjekts)	typ. 0.1 mm (abhängig von der Oberfläche des Messobjekts)	(abhängig von der Oberfläche des Messobjekts)
Optisches Filter	Rotlichtfilter RG630 + Interferenzfilter			
Spannungsversorgung	+12VDC ... +32VDC, verpolsicher, überlastsicher			
Wechsellichtbetrieb	typ. 100 kHz			
Umgebungslicht	bis 5000 Lux			
Schutzart	IP67			
Stromverbrauch	ca. 110 mA			
Schnittstelle	RS 232, parametrisierbar unter Windows®			
EMV Prüfung nach	IEC - 801... 			
Steckerart	Verbindung zur SPS: 4-pol. M8-Stecker, Verbindung zum PC: 5-pol. Flanschdose Binder Serie 712			
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +55°C			
Lagertemperaturbereich	-20°C bis +85°C			
Gehäuse	Aluminium, blau eloxiert			
max. Schaltstrom	100 mA, kurzschlussfest			
Schaltfrequenz	typ. 3 kHz (abhängig von der Parametereinstellung)		typ. 300 Hz (abhängig von der Parametereinstellung)	
Ausgänge	einstellbar über PC: npn-Öffner/npn-Schließer (=Qinv), pnp-Öffner / npn-Schließer (=Q) 1x Toleranz (Fenster) 1x Referenz (Schaltschwelle)		einstellbar über PC: npn-Öffner/npn-Schließer (=Qinv), pnp-Öffner / npn-Schließer (=Q) 1x Analog (0 ... +10V)	
Hell-/Dunkelschaltung	parametrisierbar unter Windows®			
Laserleistungsregelung	parametrisierbar unter Windows®			
Pulsverlängerung	0 ms, 25 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms (parametrisierbar unter Windows®)			
Schalthysterese	parametrisierbar unter Windows®			
Schaltzustandsanzeige	über eine im M8-Stecker integrierte orange LED			
Mittelwertbildung	von 1 bis 64 Werte (parametrisierbar unter Windows®)			
Spotgröße im Fokus	typ. Ø 0.5 mm			
Linearisierung	---	---	ja	ja

Abmessungen

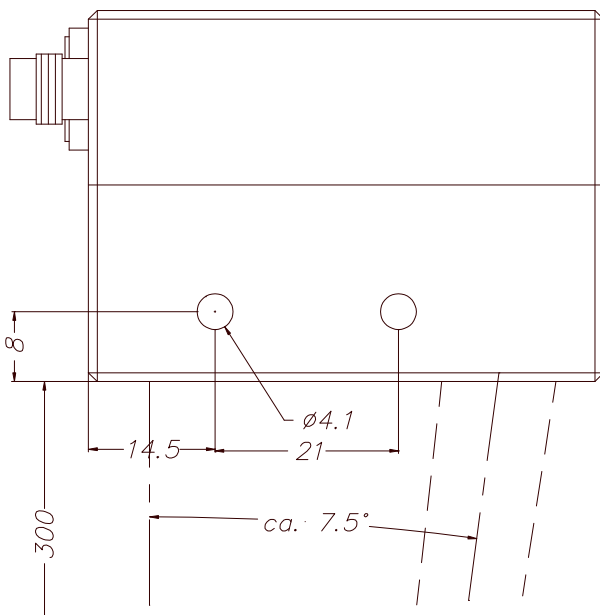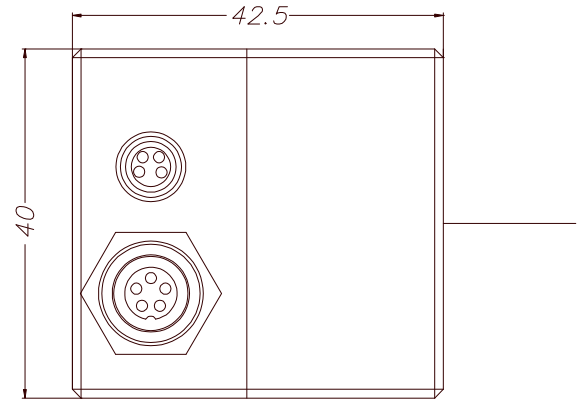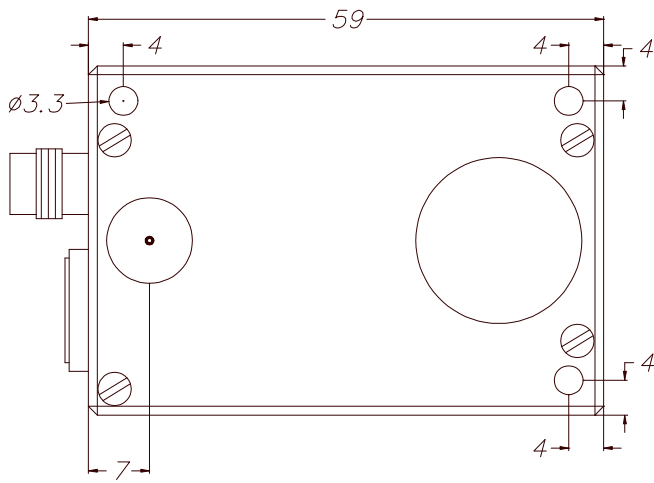


(Alle Abmessungen in mm)

## Anschlussbelegung



**Anschluss an SPS: 4-pol. M8-Stecker****R-LAS-LT-300 bzw.  
R-LAS-LT-300-XL:**

Pin-Nr.:	Farbe:	Belegung:
1	br	+12VDC...+32VDC
2	ws	TOLOUT (100mA)
3	bl	GND (0V)
4	sw	REFOUT (100mA)

**Anschluss an PC: 5-pol. Buchse Binder 712****R-LAS-LT-300 (alle Typen):**

Pin: Belegung:

1	GND (0V)
2	TX0
3	RX0
4	n.c.
5	n.c.

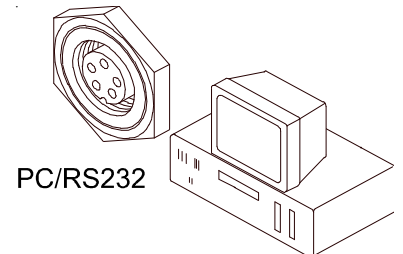

PC/RS232



**R-LAS-LT-300-ANA bzw.****R-LAS-LT-300-ANA-XL:**

Pin-Nr.:	Farbe:	Belegung:
1	br	+12VDC...+32VDC
2	ws	ANALOG (0...+10V)
3	bl	GND (0V)
4	sw	DIGITAL OUT

## Anschlusskabel

**Anschlusskabel:**

<b>an SPS:</b>	<b>cab-M8/4-g-2</b>	Länge: 2m Mantel: PU
	<b>cab-M8/4-g-5</b>	Länge: 5m Mantel: PU
<b>an PC:</b>	<b>cab-las5/PC</b>	Länge: 2m Mantel: PU

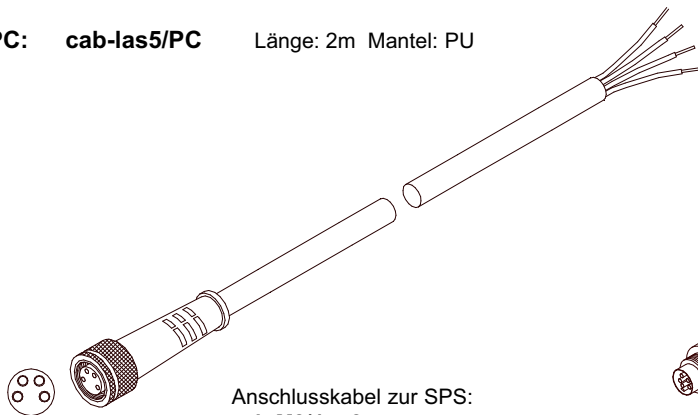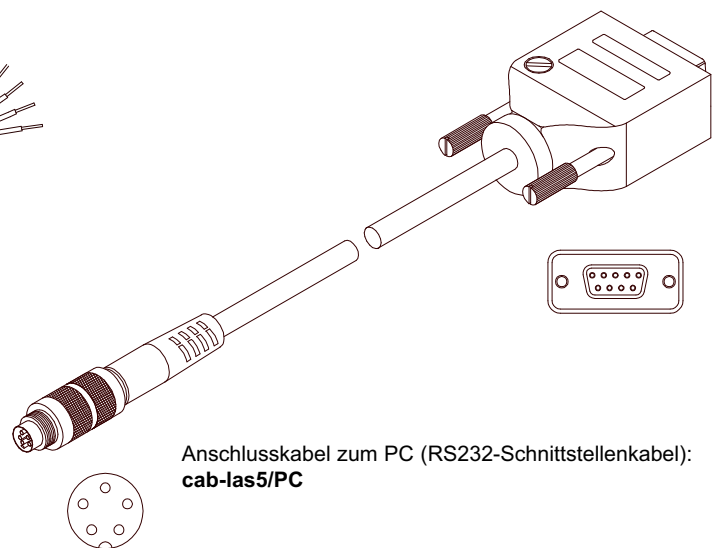Anschlusskabel zur SPS:  
**cab-M8/4-g-2**Anschlusskabel zum PC (RS232-Schnittstellenkabel):  
**cab-las5/PC**

## Laserwarnhinweis

Die Laser-Reflex-Lichttaster der R-LAS-LT Reihe entsprechen der Laserklasse 2 gemäß EN 60825. Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Laser-Reflex-Lichttaster der R-LAS-LT Reihe werden mit einem Laserwarnschild geliefert.




**Nicht  
in den Strahl  
blicken  
Laser Klasse 2**

**Parametrisierung**

**Parametrisierung unter Windows® mit Software RT-Scope:**






Die Parametrisierung der Laser-Reflex-Taster der R-LAS-LT Reihe erfolgt unter Windows® mit Hilfe der Software RT-Scope. Die Parametereingabe erfolgt über die serielle Schnittstelle RS232 unter Windows®. Sämtliche Parameter werden im EEPROM des R-LAS-LT abgelegt.

**Parametereinstellung:**



**Toleranz, Referenz:**  
Softwareschieber für Referenzwert bzw. Toleranzwert. Durch Anklicken des TEACH REF-Feldes wird der aktuelle Abstandswert (normierter Wert) als neuer Referenzwert im nichtflüchtigen Speicher des Lasertasters abgelegt.

Mit Hilfe des Softwareschiebers kann die zulässige Abweichung (+/-) des normierten Wertes (Abstandwertes) vom Referenzwert per Mausclick eingestellt werden. Eine Schaltzustandsänderung erfolgt bei Verlassen des Toleranzbandes an Pin2 des 4-pol. M8-Steckers (TOLOUT). Ein zusätzlicher Softwareschieber erlaubt die Einstellung des Referenzwertes; bei Unter- bzw. Überschreitung des Referenzwertes durch den aktuellen Abstandswert erfolgt eine Schaltzustandsänderung an Pin4 des 4-pol. M8-Steckers (REFOUT).

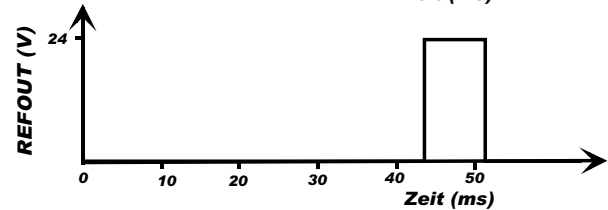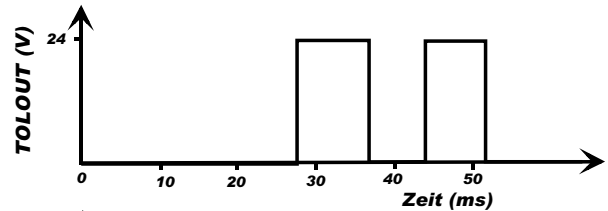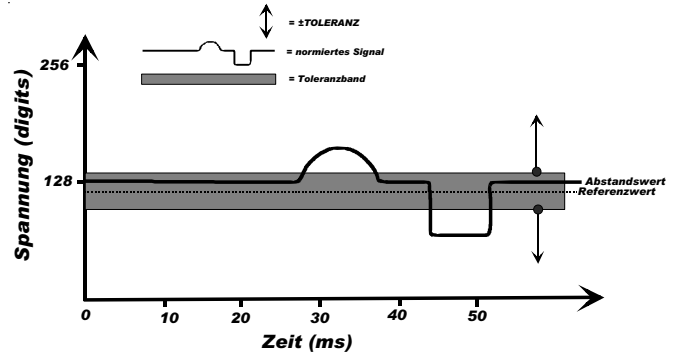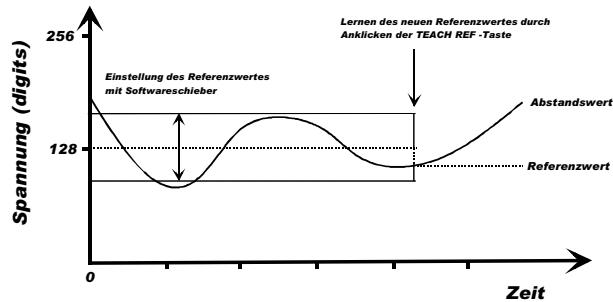


**Laserleistung, Leistungsnachregelung (LASMOD, POWER):**

Die Laserleistung lässt sich ebenso über einen Softwareschieber einstellen. Dabei ist zu beachten, dass die Laserleistung nur dann verändert werden kann, wenn der Softwareschalter für die Laserleistungsregelung LASMOD auf STAT gesetzt wurde. Desweiteren kann die Laserleistungsregelung unter Windows® mit einem "Mausclick" im Softwarefeld LASMODE EIN (DYN) oder AUS (STAT) geschaltet werden. Bei aktiver Laserleistungsregelung versucht der Lasertaster die Summe der beiden Eingangssignale ("RAW-Daten") auf den Wert 256 zu bringen. Zu beachten ist, dass die Laserleistungsnachregelung im Modus INTENSITY im MEASURE-Feld auf STAT geschaltet werden muss.



**Schalthyserese (HYSTERESIS):**

Unterschiedliche Applikationen erfordern unter Umständen eine einstellbare Schalthyserese. Für die Einstellung der Schalthyserese ist ebenfalls ein Softwarefeld vorgesehen.




**Pulsverlängerung, Hell-, Dunkelschaltung (HOLD, POLARITY):**

Bei einer minimalen Scanzeit von 150µs haben die meisten SPS Schwierigkeiten, den relativ kurzen Schaltimpuls wahrzunehmen. Bei den Lasersensoren der R-LAS-Serie kann unter Windows® eine Pulsverlängerung über Softwareschalter im Feld HOLD[m] aktiviert werden. Dabei kann zwischen einer Pulsverlängerung von 0ms bis 200ms gewählt werden.



Mit dem Softwareschalter POLARITY kann zwischen Hell- und Dunkelschaltung gewählt werden.



**Parametrisierung**
**Mittelwertbildung (AVERAGING):**

Im Feld AVERAGING kann zwischen mehreren Stufen gewählt werden. Die angeklickte Zahl gibt dabei die Anzahl der Werte an, über die gemittelt werden soll. Die maximale Anzahl von Werten, über die gemittelt werden kann ist dabei 64, d.h. es ist somit eine Genauigkeitssteigerung um den Faktor 8 möglich.


**Kontrollmodus (MEASURE):**

Es kann zwischen DIST-Mode und INTENSITY-Mode per Mausklick gewählt werden.

Im DIST-Mode erfolgt dabei eine Normierung der beiden Eingangssignale (RAW-Daten) nach folgendem Algorithmus:

$(U1-U2)/(U1+U2)$  U1, U2 = Eingangssignale

Im DIST-Mode erfolgt damit eine intensitätsunabhängige Abstandskontrolle, wogegen im INTENSITY-Mode der Mittelwert der beiden Eingangssignale von Interesse ist:  $(U1+U2)/2$ . Es erfolgt damit eine intensitätsabhängige Auswertung (Kontrastauswertung).

**Hintergrundaussblendung (BACK\_LIM):**

Die Lasertaster der R-LAS-LT Reihe arbeiten nach dem Triangulationsprinzip. Die Auswertung erfolgt über einen intensitätsunabhängigen Algorithmus. Dieser normierte Wert gibt dabei Auskunft über den Abstand. Eine zusätzliche Hintergrundausblendung erfolgt durch eine zusätzliche Überwachung des Mittelwertes der beiden Eingangssignale U1 bzw. U2:

$(U1+U2)/2$ . Unterschreitet nun dieser Mittelwert den vorgegebenen BACK-LIM-Wert, so wird der errechnete normierte Wert  $(U1-U2)/(U1+U2)$  durch den Wert 256 ersetzt, d.h. bei sehr niedrigen Signalpegeln (meist vom Hintergrund verursacht) erfolgt anstelle der unsicheren Abstandsangabe ein "biasing" auf unendlich großen Abstand (entspricht 256).

**Graphische Darstellung:**


Die Einstellung der Lasertaster der R-LAS-LT Reihe wird erheblich durch die graphische Darstellung der beiden Empfangssignale bzw. des Normsignals auf dem PC unter Windows® unterstützt.

**Starten der graphischen Darstellung (GO/STOP):**


Gestartet wird die graphische Anzeige unter Windows® durch Anklicken des GO-Feldes. Durch Anklicken des STOP-Feldes wird die graphische Aufzeichnung auf dem PC-Bildschirm beendet.

**Graphische Darstellung (SOURCE):**

Im Feld SOURCE kann durch "Mausklick" zwischen den beiden Empfangssignalen RAW und dem errechneten Signal MEASURE (abhängig von MEASURE-Modus INTENSITY bzw. DIST) gewählt werden.

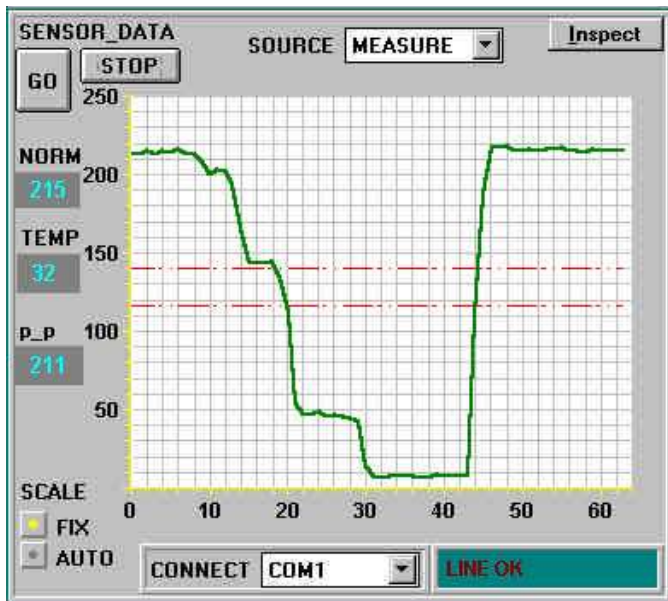

Graphische Darstellung des errechneten MEASURE-Signals

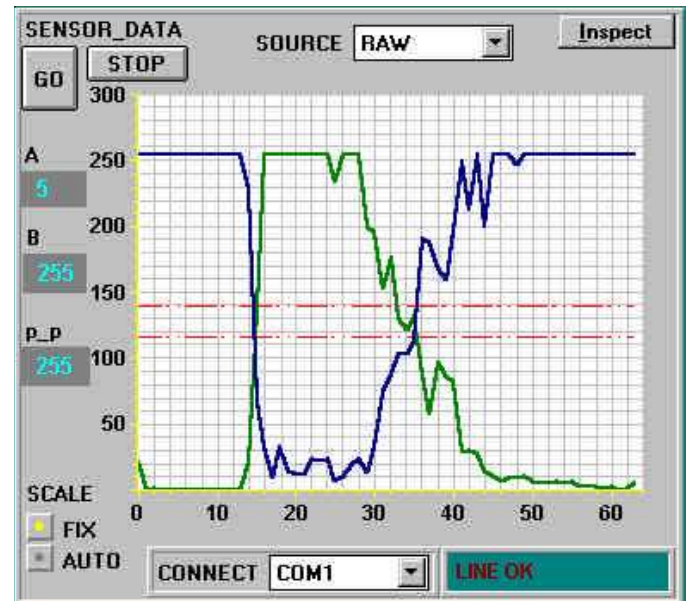

Graphische Darstellung der gemessenen RAW-Signale



**Parametrisierung**
**Auswahl der Schnittstelle (CONNECT):**

Im Softwarefeld CONNECT erfolgt die Auswahl der verwendeten seriellen Schnittstelle (COM1 bis COM4). Die Info LINE OK bzw. TIME OUT informiert über Erfolg bzw. Misserfolg des Verbindungsaufbaus zwischen Lasertaster und PC.

**Darstellungsart (SCALE):**

Das Softwarefeld SCALE ermöglicht eine Auswahl zwischen FIX, d.h. Anzeige über 256 Digits (gesamter 8-Bit-Bereich) und AUTO, wobei hier nur der vom Signal her interessante Bereich eingeblendet wird.

**Auslesen der Parameter (MEM) aus Lasertaster bzw. Datei:**

Nach dem Mausklick auf die GET-Taste können die Parameter je nach Schalterstellung aus dem RAM bzw. EEPROM des Lasertasters, oder aber aus einer Datei von der Festplatte bzw. Diskette abgerufen werden.

**Druckmodus (Inspect):**


Durch Anklicken des Inspect-Feldes erfolgt ein Ausdruck der am Bildschirm dargestellten Signale.

**Numerische Anzeige:**

Die jeweils zuletzt eingelesenen Werte werden numerisch zur Anzeige gebracht. Bei SOURCE MEASURE wird dabei der ermittelte DIST- bzw. INTENSITY-Wert, ein relativer Temperaturwert und der "peak-to-peak"-Wert des dargestellten DIST- bzw. INTENSITY-Signals angezeigt. Im SOURCE-Modus RAW erfolgt eine Anzeige der aktuellen Eingangssignale A und B bzw. des "peak-to-peak"-wertes des A-Signals.

**Abspeichern der Parameter (MEM) im Lasertaster bzw. Datei:**

Die mit Hilfe der Softwareschieber bzw. Softwareschalter eingegebenen Parameter können über die "Software-taste" SEND ins RAM bzw. ins EEPROM des Lasersensors übergeben werden. Bei Auswahl des FILE-Schalters können die Parameter in einer frei wählbaren Datei auf Diskette oder Festplatte abgelegt werden. Zu beachten ist, dass die Daten bei Ablage im RAM nach dem Ausschalten des Lasertasters verloren gehen!

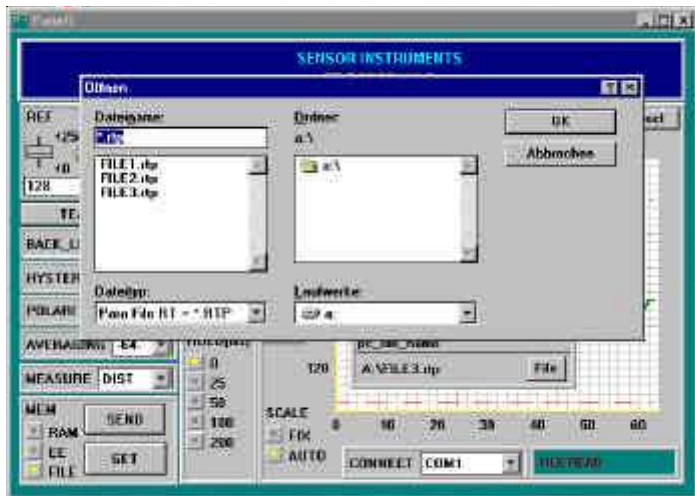


Nach Anklicken des FILE-Schalters im MEM-Feld wird im Grafik-Fenster ein pc\_file\_name-Feld geöffnet, das über die aktuell ausgewählte Datei zeigt. Durch Anklicken von FILE im pc\_file\_name-Feld kann eine andere Datei ausgewählt bzw. erstellt werden.

**Arbeiten mit den Lasertastern der R-LAS-LT Reihe:**

Nach Eingabe der Parameter und Justage des Sensors mit Unterstützung durch die graphische Darstellung auf dem PC-Display ist der PC für die eigentliche Kontrollaufgabe des Lasersensors nicht mehr erforderlich.

PC incl. Schnittstellenkabel kann dann vom Sensor entfernt werden.

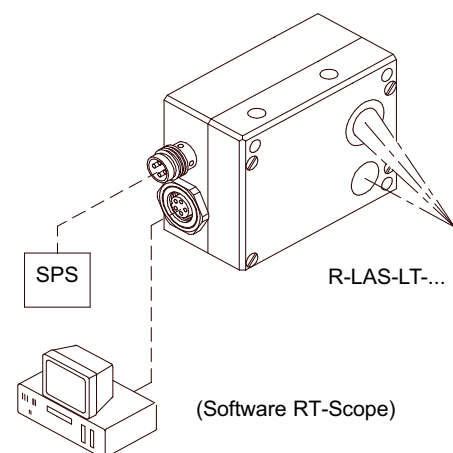



**Notizen**